

Milicz, 03.07.2015 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP9/2015

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane 1 x75 cm z odpowiednim przeliczeniem szatek, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 1-3 szwów pakowanych 1x75cm.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70cm również długość 75cm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 67:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 11 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycji 67 szwu z igłą 11mm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 71-79:

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 71-79 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 20:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 2 w pozycji 20 szwu z igłą 70mm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 10 i 14:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 i 14 igłę o długości 45cm i nić o długości 100cm

lub

igłę o długości 60mm z nicią o długości 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 10 i 14 igły o długości 45cm i nić o długości 100cm, oraz igły o długości 60mm z nicią o długości 100cm przy zachowaniu

pozostałych parametrów szwu bez zmian. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji Nr 10 i 14 z Pakietu Nr 2 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5,6:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5,6 nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 5, 6 nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-18:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 2 pozycji 1-18 do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawę korzystnych cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 1-18 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5,6,12,17:

Pakiet nr 2 poz. 5, 6, 12, 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 5,6,12,17 szwów o długości 75cm.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5,6,14,14,16,17:

Pakiet nr 2 poz. 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w kolorze czarnym?

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 5,6,9,10,12,14,16,17 szwów w kolorze czarnym.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 10,14,16:

Pakiet nr 2 poz. 10, 14, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

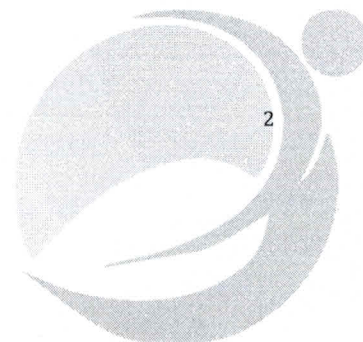

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 10,14,16 szwów o długości 75cm.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 10,14,16:

Pakiet nr 2 poz. 10, 14, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 39 lub 40mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 10,14,16 szwów z igłą o długości 39 lub 40mm. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji nr 10,14,16 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 12,17:

Pakiet nr 2 poz. 12, 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 12,17 szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 19:

Pakiet nr 2 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 2 w pozycji 19 szwów z igłą o długości 20mm.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 20:

Pakiet nr 2 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą pojedynczą o dł. 60mm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji 20 szwów z igłą odwrotnie tnącą pojedynczą o długości 60mm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji nr 20 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 21:

Pakiet nr 2 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 6/0 z igłą odwrotnie tnącą dwuwkłęską o dł. 13mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji 21 szwów o grubości 6/0 z igłą odwrotnie tnącą dwuwkłęską o długości 13mm. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji nr 21 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 27,28:

Pakiet nr 2 poz. 27, 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 27,28 szwów z igłą o długości 36mm. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji nr 27,28 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 29-31:

Pakiet nr 2 poz. 29-31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 29-31 szwów z igłą o długości 36mm.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 32-35:

Pakiet nr 2 poz. 32-35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 250mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycjach 32-35 szwów o długości 250mm.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1:

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów ze zszywkami bez pokrycia teflonem o grubości 0,6mm, szerokości 7,2mm, wysokości 4,9mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 w pozycji nr 1 staplerów ze zszywkami bez pokrycia teflonem o grubości 0,6mm, szerokości 7,2mm, wysokości 4,9mm.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1:

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów w opakowaniach zbiorczych a 5 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (12 op.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 5 w pozycji nr 1 w opakowaniach zbiorczych a 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2:

Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów w opakowaniach zbiorczych a 20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (3 op.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 5 w pozycji nr 2 przyrządów w opakowaniach zbiorczych a 20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.5 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 5 nici o długości 75cm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.6 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?


Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 6 nici o długości 75cm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.9 również na nici w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

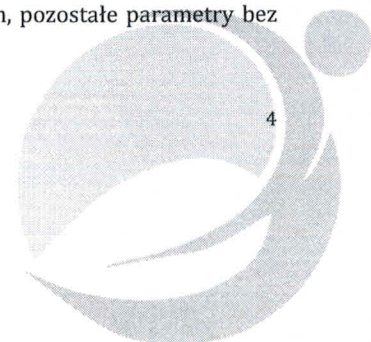

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 9 nici w kolorze Czernym o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.10 również na długość igły 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 10 igły o długości 39mm z nicią 75cm.

PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.12 również na najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 12 najnowszej generacji igły typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.12 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 12 długość nici 75cm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.14 również na długość igły 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 14 igły 39mm z nicią 75cm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.16 również na długość igły 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 16 igły 39mm z nicią 75cm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.17 również na najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 17 najnowszej generacji igły typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.17 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 w pozycji nr 17 nici o długości 75cm, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-18:

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu nr 2 pozycje od 1 do 18 i utworzy z nich odrębne zadanie?

UZASADNIENIE: Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 1-18 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 14,17,77,78:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 14 ze szwem o długości 70 cm.
- w pozycji nr 17 ze szwem o długości 90 cm z igłą 40 mm wzmocnioną 1/2 koła okrągłą
- w pozycji 77 ze szwem o długości 90 cm z igłą 37 mm wzmocnioną 1/2 koła okrągłą ze szwem bezbarwnym, ponieważ nie występuję w/w szew w kolorze fioletowym
- w pozycji 78 ze szwem o długości 70 cm z igłą 30 mm 1/2 koła okrągłą ze szwem bezbarwnym, ponieważ nie występuję w/w szew w kolorze fioletowym

Odpowiedź Zamawiającego:

- w pozycji nr 14 ze szwem o długości 70cm – **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
- w pozycji nr 17 ze szwem o długości 90cm z igłą 40 mm wzmocnioną 1/2 koła okrągłą – **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
- w pozycji 77 ze szwem o długości 90cm z igłą 37mm wzmocnioną 1/2 koła okrągłą ze szwem bezbarwnym, ponieważ nie występuję w/w szew w kolorze fioletowym – **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**
- w pozycji 78 ze szwem o długości 70cm z igłą 30mm 1/2 koła okrągłą ze szwem bezbarwnym, ponieważ nie występuję w/w szew w kolorze fioletowym – **Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody w poz. 1 na zaferowanie hemostatyku wykonanego z materiału roślinnego (100% utlenionej celulozy) o wymiarach 5 x 7 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w Pakiecie Nr 4 w pozycji nr 1 hemostatyku wykonanego z materiału roślinnego (100% utlenionej celulozy) o wymiarach 5 x 7cm.

PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 4 pozycja 1 gazy o właściwościach bakterioobójczych na MRSA, MRSE, VRE potwierdzonych w badaniach i instrukcji użytkowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w Pakiecie Nr 4 w pozycji nr 1 gazy o właściwościach bakterioobójczych na MRSA, MRSE, VRE potwierdzonych w badaniach i instrukcji użytkowania.

PYTANIE NR 39: Dotyczy Pakietu Nr 4:

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 4 hemostatyk, który ma niskie pH w przedziale 2,5-3,0, zapewnia czas krzepnięcia krwi w 3-4 minuty i czas wchłaniania 7-14 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie Nr 4 hemostatyk, który ma niskie pH w przedziale 2,5-3,0, zapewnia czas krzepnięcia krwi w 3-4 minuty i czas wchłaniania 7-14 dni.

PYTANIE NR 40: Dotyczy Pakietu Nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 hemostatyk wykonany z utlenionej celulozy o nazwie handlowej Zeocel? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie Nr 4 hemostatyk wykonany z utlenionej celulozy o nazwie handlowej Zeocel, o pozostałych parametrach zgodnych z siwz.

PYTANIE NR 41: Dotyczy Pakietu Nr 4:

Czy Zamawiający wymaga aby zawartość grupy karboksylowej dla hemostatyków z pakietu nr 4 wynosiła minimum 18%?

Uzasadnienie: Większa zawartość grup karboksylowej zmniejsza szansę powstawania rodników. Większa ilość rodników w organizmie powoduje powstawanie reaktywnych form tlenu (RFT), które doprowadzają do uszkodzenia

kodu genetycznego, prowadzą do powstawania nowotworów, zaburzeń czynnościowych układu krążenia, mózgu i innych narządów, a także są przyczyną starzenia się komórek. Utleniając cholesterol (LDL) powodują zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych nawet u osób młodych. W szczególności narażony na działanie RTF czy rodników jest mózg, gdzie nieodwracalna śmierć neuronów mózgowych doprowadza do takich chorób jak Alzheimer czy Parkinson.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga aby zawartość grupy karboksylowej dla hemostatyków z pakietu nr 4 wynosiła minimum 18%.

PYTANIE NR 42: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **pakiecie nr 3** wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli (75%), parafina (15%) i palmitynian izopropylu (10%)? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli (75%), parafina (15%) i palmitynian izopropylu (10%).

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3:

Dotyczy **zadania nr 3**: czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie **pozycji 3** do osobnego zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu Nr 3 pozycji nr 3 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **pakiecie nr 3** wosku kostnego pakowanego w saszetki po 2,5 g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 wosku kostnego pakowanego w saszetki po 2,5g z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, tak aby oferta była porównywalna.

PYTANIE NR 45:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: *Kupujący zastrzeżę sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy. Sprzedawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy.*

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. **Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji.**”

Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 *in principio* ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 teże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. **W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.**

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji”). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że **niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.** „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co do zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 46: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie hemostatyku wykonanego z materiału roślinnego [100% utleniona celuloza] pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie hemostatyku wykonanego z materiału roślinnego [100% utleniona celuloza] o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x 60 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 1 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x 60, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 48: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x55 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 2 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x55, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 49: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,50x50 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 3 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,50x50, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 50: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,30x40 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 5 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,30x40, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 51: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,10x30 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 6 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,10x30, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 52: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,00x25 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 7 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,00x25, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 53: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x60 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 8 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x60, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 54: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x55 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 9 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,60x55, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 55: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,50x50 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 10 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,50x50, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 56: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,30x40 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 12 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,30x40, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 57: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,10x30 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 13 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,10x30, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 58: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,00x25 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 14 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,00x25, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 59: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 1,00x45 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 15 igły chirurgicznej dł. (mm) 1,00x45, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 60: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 0,90x36 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 16 igły chirurgicznej dł. (mm) 0,90x36, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 61: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 0,80x32 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 17 igły chirurgicznej dł. (mm) 0,80x32, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 62: Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły chirurgicznej dł. (mm) 0,70x25 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 w pozycji nr 18 igły chirurgicznej dł. (mm) 0,70x25, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 63: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów skórnych posiadających szerokie zszywki o wymiarach: szerokość 7,0mm, wysokość nóżki 4,0 mm, średnica zszywki 0,6mm. Staplery pakowane w opakowania po 10 szt. – z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania staplerów skórnych posiadających szerokie zszywki o wymiarach: szerokość 7,0mm, wysokość nóżki 4,0 mm, średnica zszywki 0,6mm. Staplery pakowane w opakowania po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 64: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek pakowany w opakowania a'10szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek pakowany w opakowania a'10szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 65: Dotyczy projektu umowy §4 ust. 3:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 3 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 66: Dotyczy projektu umowy §7 ust. 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 1. 0,5% wartości **brutto** nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 1 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 67: Dotyczy projektu umowy §7 ust. 2:

0,5% wartości **brutto** dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów wadliwych**, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4. ust. 3 umowy,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 2 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 68: Dotyczy projektu umowy :

10% wartości brutto **niezrealizowanej** części umowy pozostałej do realizacji – w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

- a. nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw,
- b. jednorazowej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
- c. trzykrotnej reklamacji przedmiotu zamówienia.
- d. 10% wartości brutto **niezrealizowanej** części umowy pozostałej do realizacji – w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 69: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidział możliwość zmiany umowy w związku ze zmianą stawki podatkowej VAT.

PYTANIE NR 70: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-52:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycjach 1-52 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (POLYSORB) o następującej charakterystyce:

Szew wchłaniający pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktanu/glikolidu i laktynu stearylowo-wapniowego o początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego 140%, po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni.

- Pozycja 1,2,3 : nici pakowane pojedynczo długości 75cm
- Pozycja 5,6,8,11,12,13,16,24,25,27, - nici długości 75cm
- Pozycja 9 - igłę 27mm
- Pozycja 10 - igłę 27mm i nici długości 75cm
- Pozycja 15 - nici grubości „1” i długości 75cm
- Pozycja 23 - nici niebarwione długości 100cm
- Pozycja 26 - igłę 76mm i nić długości 75cm
- Pozycja 29 - igłę haczykową typu „J” o zakończeniu okrągłym długości 32mm i nici 75cm
- Pozycja 30 - nić loop o długości 120cm
- Pozycja 31 - nić długości 90cm
- Pozycja 36 - nici pakowane 6x75cm
- Pozycja 42,43,44,50- nici pakowane 3x75cm
- Pozycja 45,46,47,48,49 - nici długości 150cm
- Pozycja 51,52 - nici pakowane 6x75cm

Odpowiedź Zamawiającego:


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 1-52 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (POLYSORB) o następującej charakterystyce:

Szew wchłaniający pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktanu/glikolidu i laktynu stearylowo-wapniowego o początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego 140%, po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni.

- Pozycja 1,2,3 : nici pakowane pojedynczo długości 75cm
- Pozycja 5,6,8,11,12,13,16,24,25,27, - nici długości 75cm
- Pozycja 9 - igłę 27mm
- Pozycja 10 - igłę 27mm i nici długości 75cm
- Pozycja 15 - nici grubości „1” i długości 75cm
- Pozycja 23 - nici niebarwione długości 100cm
- Pozycja 26 - igłę 76mm i nić długości 75cm
- Pozycja 29 - igłę haczykową typu „J” o zakończeniu okrągłym długości 32mm i nici 75cm
- Pozycja 30 - nić loop o długości 120cm
- Pozycja 31 - nić długości 90cm
- Pozycja 36 - nici pakowane 6x75cm
- Pozycja 42,43,44,50- nici pakowane 3x75cm
- Pozycja 45,46,47,48,49 - nici długości 150cm
- Pozycja 51,52 - nici pakowane 6x75cm

PYTANIE NR 71: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 53-60:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycjach 53-60 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (VELOSORB) o następującej charakterystyce:

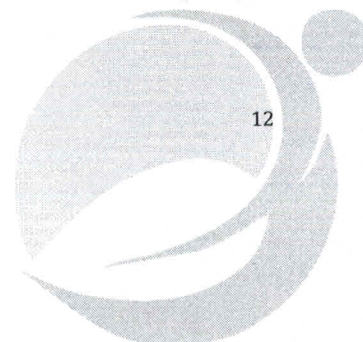

Szew wchłaniający, pleciony, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany kopolimerem kaprolaktanu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 45% - 55 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach 0%, o czasie wchłaniania 40 – 50 dni.

- Pozycja 53,54,55,56,57,58: nici długości 75cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 53-60 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (VELOSORB) o następującej charakterystyce:

Szew wchłaniający, pleciony, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany kopolimerem kaprolaktanu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 45% - 55 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach 0%, o czasie wchłaniania 40 – 50 dni.

- Pozycja 53,54,55,56,57,58: nici długości 75cm

PYTANIE NR 72: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 61-70:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycjach 61-70 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (BIOSYN) o następującej charakterystyce:

szew wchłaniający monofilamentowy składający się z glikolidu, laktydu, dioksanonu, węglanu trimetylenu o unikalnym podtrzymywaniu tkankowych wynoszącym 75% pierwotnej wytrzymałości po 14 dniach i 40% pierwotnej wytrzymałości po 21 dniach o czasie wchłaniania 90-110 dni.

- Pozycja 61,63: igłę 27mm i nici długości 75cm

- Pozycja 62,64,65,66,69 : nici długości 75cm

- Pozycja 67 – igłę 2x13mm i nić 75cm

- Pozycja 68 – igłę 27mm i nić 75cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 61-70 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (BIOSYN) o następującej charakterystyce:

szew wchłaniający monofilamentowy składający się z glikolidu, laktydu, dioksanonu, węglanu trimetylenu o unikalnym podtrzymywaniu tkankowych wynoszącym 75% pierwotnej wytrzymałości po 14 dniach i 40% pierwotnej wytrzymałości po 21 dniach o czasie wchłaniania 90-110 dni.

- Pozycja 61,63: igłę 27mm i nici długości 75cm

- Pozycja 62,64,65,66,69 : nici długości 75cm

- Pozycja 67 – igłę 2x13mm i nić 75cm

- Pozycja 68 – igłę 27mm i nić 75cm

PYTANIE NR 73: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 71-79:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycjach 71-79 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (CAPROSYN) o następującej charakterystyce:

szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni.

- Pozycja 71,72,73,74,75,76,79 : nici długości 75cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 71-79 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (CAPROSYN) o następującej charakterystyce:

szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni.

- Pozycja 71,72,73,74,75,76,79 : nici długości 75cm

PYTANIE NR 74: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 80:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 80 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (MAXON) o następującej charakterystyce:

szew syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycji 80 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (MAXON) o następującej charakterystyce:

szew syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni.

PYTANIE NR 75: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 81-82:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycjach 81-82 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (POLYSORB) o następującej charakterystyce:

Szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktanu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego 140%, po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni.

- Pozycja 82: nici bezbarwne 100cm lub fioletowe 150cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 81-82 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (POLYSORB) o następującej charakterystyce:

Szew wchłaniany pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego powlekany kopolimerem kaprolaktanu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o początkowej zdolności podtrzymywania tkankowego 140%, po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni.

- Pozycja 82: nici bezbarwne 100cm lub fioletowe 150cm

PYTANIE NR 76: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 83:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 83 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (MAXON) o następującej charakterystyce:

szew syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni

- prosimy o dopuszczenie szwu w kolorze zielonym

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 1 w pozycji 83 obok istniejących zapisów nici chirurgicznych (MAXON) o następującej charakterystyce:

szew syntetyczny, monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania do 180 dni

- szwu w kolorze zielonym.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 08.07.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki
Maciej Biardzki