

Milicz 07.09.2015 r.


Nr referencyjny postępowania: MCM/SZ/17/2015

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1,
tel. (71)38 46 754, fax. (71)38 40 652

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., w Miliczu, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje **zapytanie o przedstawienie oferty cenowej**, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na dostawę aparatu USG dla oddziału wewnętrznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu o niżej wymienionych wymaganiach /parametrach/ :

1. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.
2. Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2015
3. Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu - wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2013 roku lub później
4. Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.
5. Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3
6. Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali.
7. Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
 - B,
 - B + B
 - M
 - B + M
 - D
 - B + D
 - B + C (Color Doppler)
 - B + PD (Power Doppler)
 - B + Color + M

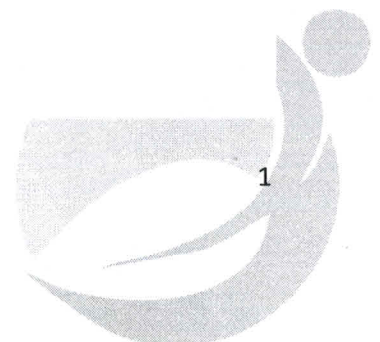

8. Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD)
9. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
10. Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
11. Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD)
12. Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory (linie proste)
13. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
14. Obrazowanie w trybie Triplex - (B+CD/PD +PWD)
15. Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy
16. Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków
17. Obrazowanie trapezowe i rombów na głowicach liniowych
18. Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów.
19. Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrive lub płytach DVD-R/RW
20. Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
21. Pełne oprogramowanie do badań:
 - Brzusznych
 - Małych narządów
 - Naczyniowych
 - Mięśniowo-szkieletowych
 - Urologicznych
 - Kardiologicznych
 - Pediatrycznych
22. Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0- 6,0 MHz
23. Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 - 13,0 MHz.
24. Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 - 5,0 MHz.
25. Videoprinter czarno-biały.
26. Certyfikat CE na aparat i głowice
27. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu)

28. Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesiące
29. Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski.

Oferty cenowe na realizację powyższej dostawy prosimy przysłać pocztą tradycyjną na adres: Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz, lub drogą mailową na adres: sz@mcm-milicz.pl lub złożyć w Biurze Zarządu Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu przy ul. Grzybowej 1, **w terminie do dnia 11.09.2015r., do godziny 14⁰⁰ według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.**

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 797307787 w dni robocze w godzinach od 8.00 – 14.00. Osoby do kontaktu: Marta Cichocka i Zdzisław Konieczny – Sekcja Zamówień Publicznych i obsługi Umów MCM sp. z o.o., w Miliczu.

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

Wykonawcy, którzy złożą oferty cenowe na powyższe zapytanie, zostaną zaproszeni do negocjacji dnia 16.09.2015r. O godzinie spotkania zostaną poinformowani oferenci drogą mailową, bądź telefoniczną.

Jeżeli okaże się, że oferty wstępne przewyższają próg 30 000,00 euro, zostanie zastosowany tryb ustawy wyłonienia Wykonawcy na dostawę aparatu USG dla oddziału wewnętrznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki